

CHỨNG NHẬN PHÂN TÍCH

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Sản phẩm: **BacterPlate™ Môi trường 2 ngăn BA/CAHI**
 Mã sản phẩm: **05045**
 Lô sản xuất: **211224**
 Hạn sử dụng: **210425**
 Bảo quản: **2°C – 8°C**
 Phương pháp: **Kiểm tra chất lượng theo quy trình: QT/KT/03.01**
 Thời gian thực hiện: **21/12/2024**

KẾT QUẢ

CHỈ TIÊU	TIÊU CHUẨN	KẾT QUẢ
Cảm quan	Bề mặt láng, đồng nhất, không gồ ghề, không phân lớp	Đạt
Màu sắc	Ngăn BA: đỏ tươi, hơi đục Ngăn CAHI: nâu, đục	Đạt
Độ pH	Ngăn CAHI: $7,3 \pm 0,2$ Ngăn BA: $7,3 \pm 0,2$	Đạt
Độ dày của thạch (mm)	4 ± 1	Đạt
Đường kính đĩa (mm)	$90 \pm 0,5$	Đạt
Thể tích (mL)	20 ± 2	Đạt
Độ vô trùng	Không có vi khuẩn mọc sau khi ủ ở $35 - 37^{\circ}\text{C}$ từ 18 – 24 giờ	Đạt

HIỆU NĂNG	TIÊU CHUẨN (Pr)	KẾT QUẢ
Điều kiện nuôi cấy từ 18 – 24 giờ, ủ ở $35 - 37^{\circ}\text{C}$, với lượng cấy $\leq 10^3 - 10^4$ CFU/ mL		
Ngăn BA		
<i>S. pneumonia</i> ATCC 49619	Mọc tốt, tiêu huyết α	Đạt
<i>S. pyogenes</i> ATCC 19615	Mọc tốt, tiêu huyết β	Đạt
<i>E. faecalis</i> ATCC 29212	Mọc tốt, tiêu huyết γ	Đạt
Ngăn CAHI		
<i>H. influenzae</i> ATCC 33533	Mọc tốt	Đạt
<i>S. pneumoniae</i> ATCC 49619	Mọc yếu hoặc không mọc	Đạt
<i>N. meningitidis</i> ATCC 13090	Mọc yếu hoặc không mọc	Đạt

KẾT LUẬN: SẢN PHẨM ĐẠT CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨN

(Vui lòng tải chứng nhận phân tích tại đường link: <https://labone.com.vn/certificate-of-analysis-coa/>)

BTL/BM/HD/QTTN/01.02


TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 12 năm 2024

Phòng Quản lý Chất lượng

Người thực hiện kiểm tra



Huỳnh Bích Trâm

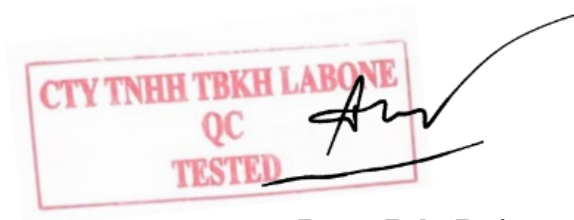

Doãn Đức Đại

LABone